


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
для Государственного реестра средств измерений

У Т В Е Р Ж Д А Ю

И.о. директора республиканского
унитарного предприятия «Гродненский
центр стандартизации, метрологии и
сертификации»



В.А. Маскевич

« 23 » июля 2017 г.

Термометры медицинские максимальные стеклянные iMed W23A, iMed W00	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 0325632017
---	--

Выпускаются по технической документации фирмы «Wuxi Medical Instrument Factory»,
(Китай).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термометры медицинские максимальные стеклянные iMed W23A, iMed W00
предназначены для измерения температуры тела человека.

Область применения – осуществление деятельности в области здравоохранения.

ОПИСАНИЕ

Термометр состоит из стеклянной оболочки, внутрь которой вставлена шкала для отсчета температуры, закрепленная на капиллярной трубке с максимальным устройством и с резервуаром, в котором находится термометрическая жидкость.


В зависимости от типа термометрической жидкости

Принцип действия термометра основан на изменении объема термометрической жидкости в зависимости от температуры тела человека.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
представлены в таблице 1

Таблица 1

Характеристика	Значение	
	iMed W23A	iMed W00
1. Диапазон измерений температуры, °С	от 35 до 42	
2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °С	± 0,1	
3. Цена деления, °С	0,1	
4. Длина термометра, мм	125 ⁺¹⁵ ₋₁₀	
5. Большая ось овала корпуса термометра, мм	12 max	
6. Термометрическая жидкость	ртуть	сплав металлов



ВНЕШНИЙ ВИД ТЕРМОМЕТРОВ

представлен на Фото 1.

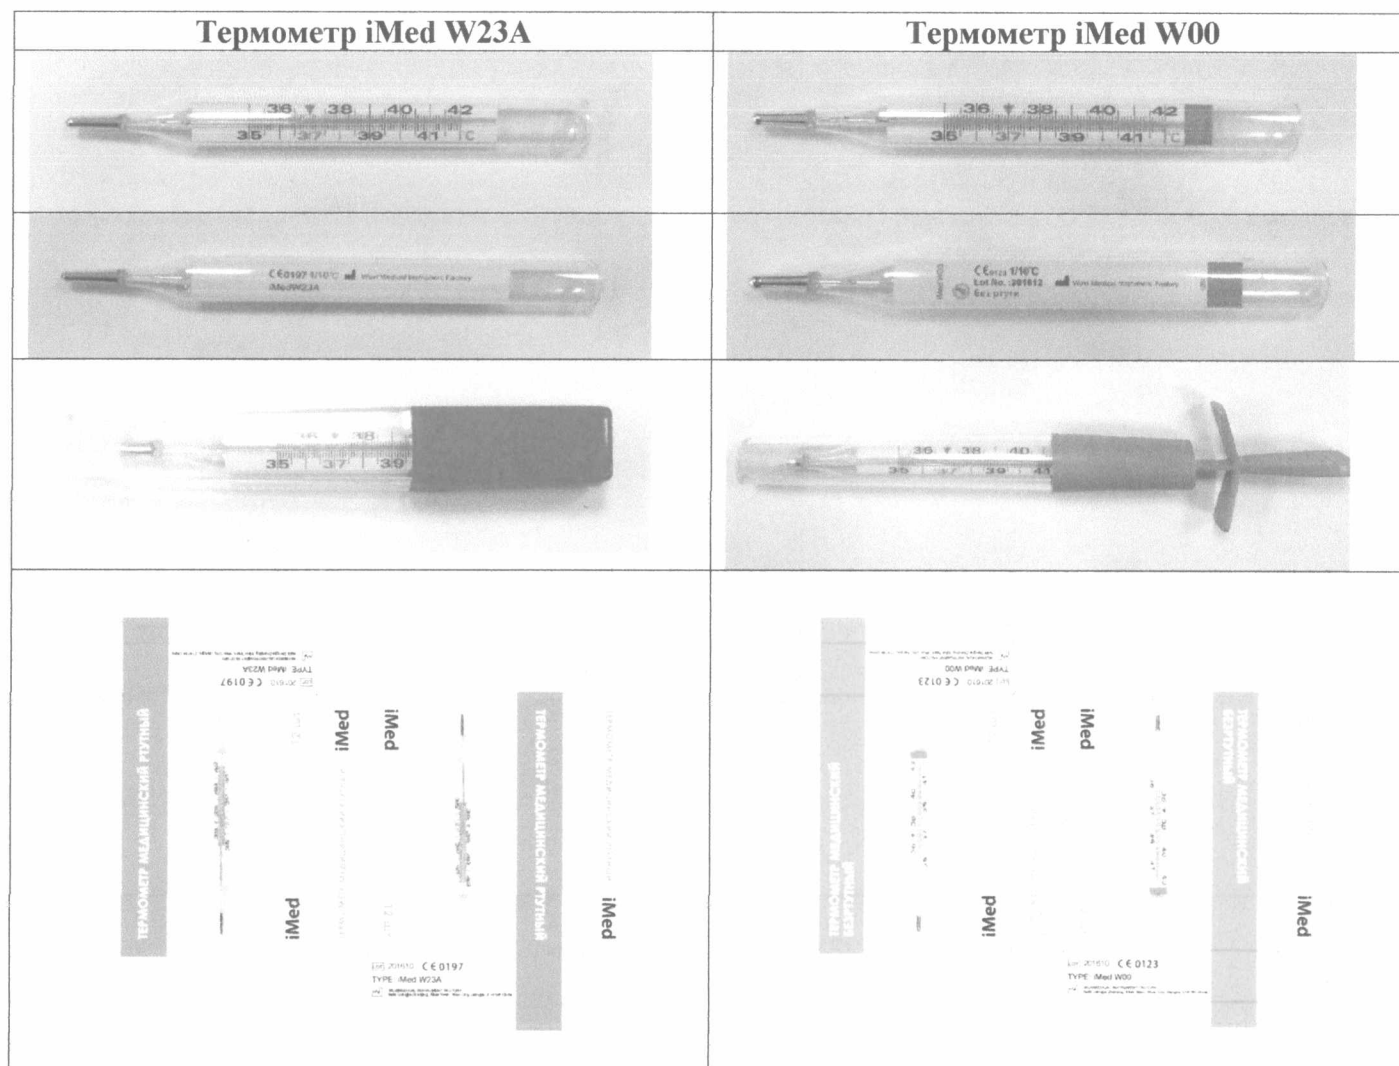


Фото 1. Внешний вид термометров iMed

Место нанесения поверительного клейма-наклейки приведено в Приложении 1.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию термометров типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование устройства	Обозначение	Кол-во штук	Примечание
Термометр	iMed W23A iMed W00	1	В соответствии с заказом
Защитный футляр		1	В соответствии с заказом
Руководство по эксплуатации		1	В соответствии с заказом



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы «Wuxi Medical Instrument Factory», (Китай).

ГОСТ 302-79 «Термометр медицинский максимальный стеклянный. Технические условия»

СТБ ЕН 12470-1-2014 «Термометры медицинские. Часть 1. Требования к термометрам жидкометаллическим стеклянным максимальным»

ГОСТ 8.250-77 «Термометры медицинские максимальные стеклянные. Методы и средства поверки»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип **Термометры медицинские максимальные стеклянные iMed W23A, iMed W00** утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем Описании типа, метрологически обеспечен при ввозе в страну и в эксплуатации в соответствии с требованиями нормативной документации. Термометры медицинские максимальные стеклянные iMed W23A и iMed W00 соответствуют технической документации фирмы «Wuxi Medical Instrument Factory», (Китай), зарегистрированы Министерством здравоохранения Республики Беларусь (номер регистрационного удостоверения № ИМ-7.104824, действительно до 04.01.2022).

Государственные приемочные испытания в соответствии с приказом Госстандарта проведены отделом метрологии республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации», пр. Космонавтов, 56, 230003, г. Гродно, факс (0152) 64 31 29, тел. (0152) 64 31 41, эл. почта csms@csms.grodno.by, аттестат аккредитации **ВУ/112 02.6.0.0004** от 24.10.2008 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Wuxi Medical Instrument Factory», (Китай).

Адрес: Wuxi Medical Instrument Factory, No.86 Dongjie Zhanjing, Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu, 214194 China
TEL: 0086-510-83791818, FAX: 0086-510-83795188
www.medical-cn.com

ИМПОРТЕР

ООО "ПроМедЛайф"

г. Минск, ул. Кутузова, д.4, комн.6
Регистрационный номер 192679837
Тел.: + 375 29 314 97 11
+ 375 29 317 79 18

Главный метролог –
начальник отдела метрологии



С.А. Цыган

Директор ООО "ПроМедЛайф"



С.И. Макей



СХЕМА
места нанесения Государственного поверительного клейма-наклейки



Место нанесения
Государственного
поверительного клейма-
наклейки

