

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 15461 от 4 августа 2022 г.

Срок действия: бессрочный

Наименование типа средств измерений:

Весы бункерные ВБ-3000 № 321

Производитель:

**Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ТЕНЗОДАТ»,
г. Минск, Республика Беларусь**

Выдан:

**Научно-производственному обществу с ограниченной ответственностью «ТЕНЗОДАТ»,
г. Минск, Республика Беларусь**

Документ на поверку:

**ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические
требования. Испытания»**

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 04.08.2022 № 75

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Первый заместитель Председателя комитета



Д.П.Барташевич

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 4 августа 2022 г. № 15461

Наименование типа средств измерений и их обозначение

Весы бункерные ВБ-3000 заводской №321.

Назначение и область применения

Весы предназначены для определения массы компонентов в режиме статического взвешивания для приготовления нестерильных оральных лекарственных препаратов.

Описание

Весы состоят из узла взвешивания и устройства управления.

Узел взвешивания представляет собой грузоприемное устройство (далее - ГПУ), выполненное в виде бункера, опирающегося на три датчика тензометрических М50-3-С3 (изготовитель фирма АО «ВИК «ТЕНЗО-М», РФ).

Устройство управления представляет собой преобразователь тензометрический ПТН-1 (изготовитель НПООО «Тензодат», РБ) и панель оператора WEINTEK MT8071IE 7.0" (изготовитель фирма «Weintek Labs., Inc.», Тайвань).

Принцип работы основан на преобразовании деформации упругого элемента тензометрического весоизмерительного датчика, возникающей под воздействием взвешиваемого груза при установке в грузоприемное устройство, в аналоговый электрический сигнал. Преобразование аналогового электрического сигнала в цифровую форму происходит в преобразователе с последующей выдачей результата на экран панели оператора.

Функциональные возможности весов:

отображение текущего значения массы;

обнуление весов;

тарирование;

индикация аварийных ситуаций.

Программное обеспечение

Управление весами реализовано с помощью программного обеспечения (далее – ПО) ver.1.0 под управлением операционной среды LINUX.

Защита от несанкционированного доступа к параметрам юстировки и настройки реализовано следующим способом:

разграничение прав доступа с использованием сервисного пароля;

невозможность изменения ПО без применения специализированного оборудования производителя.

Кроме того, для контроля изменений параметров юстировки и настройки предусмотрен несбрасываемый счетчик, значение которого может быть указано в свидетельстве.

Обязательные метрологические требования

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011	средний
Максимальная нагрузка (Max), кг	3000
Минимальная нагрузка (Min), кг	20
Действительная цена деления (d) и поверочный интервал (e), d=e, кг	1,0
Предел допускаемой погрешности, кг: от 20 до 500 вкл. свыше 500 до 2000 вкл. свыше 2000 до 3000 вкл.	± 0,5 ± 1,0 ± 1,5

Основные технические и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение
Диапазон выборки массы тары, кг	от Min до Max
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °C	от 0 до 45
Время выхода на установленный режим работы, мин, не более	10
Диапазон напряжения постоянного тока, В	от 16 до 27
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 тензометрических датчиков	IP65
Габаритные размеры ГПУ, мм, не более	1900x1900x3650
Масса ГПУ, кг, не более	2640

Комплектность

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Весы бункерные ВБ-3000 №321	шт.	1
2	Паспорт и руководство по эксплуатации	шт.	1

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта.

Поверка осуществляется по ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие требования к дозаторам

1. ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»
2. Весы бункерные ВБ-3000. Паспорт.

Перечень средств поверки

Гири класса точности М1 по ГОСТ OIML R111-1-2009.

Идентификация программного обеспечения

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 4.

Таблица 4

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже	1.0

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя

Весы бункерные ВБ-3000 заводской №321 соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»; «Весы бункерные ВБ-3000. Паспорт».

Производитель средств измерений

НПООО "ТЕНЗОДАТ" 220049, г. Минск, ул. Кнорина, д.1, корп.3, комн.218
тел./факс +375 (17) 355-75-30; e-mail: tenzodat@tut.by

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее метрологическую экспертизу единичного экземпляра средства измерений

Республиканское унитарное предприятие "Барановичский центр стандартизации, метрологии и сертификации"

ул. Чернышевского, 61/1, 225409, г. Барановичи
тел./факс (0163) 65-45-55; e-mail: brncsm@brest.by

Приложения: 1. Фотографии общего вида средства измерений.

2. Фотография с указанием места нанесения знака поверки.

Количество страниц описания типа средств измерений (с приложениями) 5.

Директор
РУП "Барановичский ЦСМС"



А.В. Карпович

Приложение 1
(обязательное)

Фотографии общего вида средства измерений

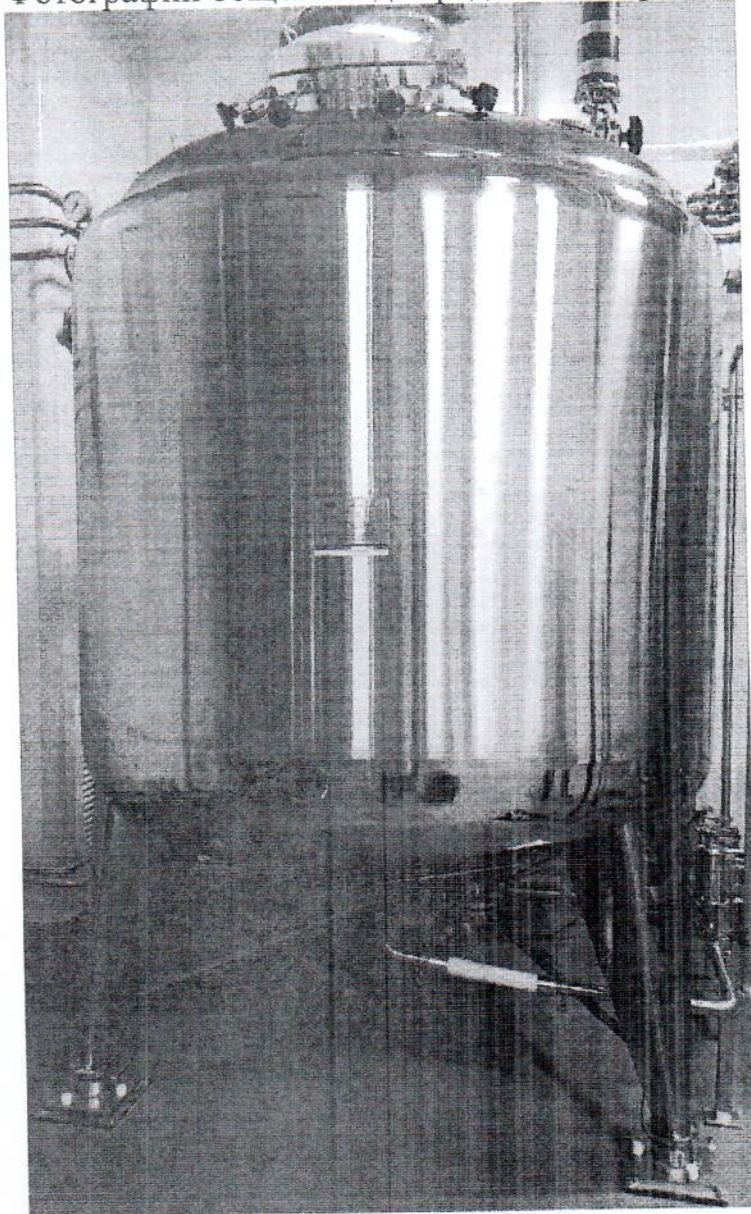


Рисунок 1.1 – Внешний вид весов бункерных ВБ-3000 №321

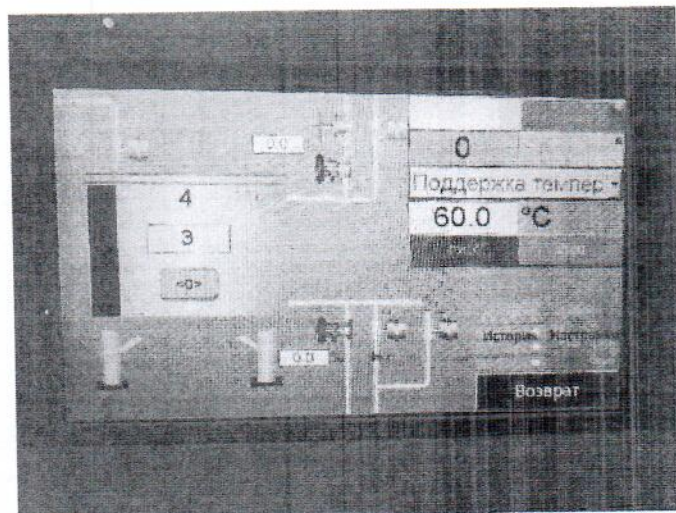


Рисунок 1.2 – Внешний вид панели оператора WEINTEK MT8071IE 7,0"

Приложение 2
(обязательное)

Фотография с указанием места нанесения знака поверки

Место нанесения знака поверки (наклейки)

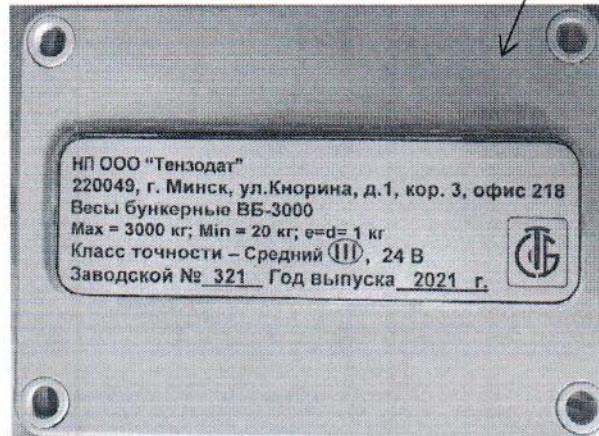


Рисунок 2.1 - Фотография с указанием места нанесения знака поверки (наклейки) на преобразователь тензометрический ТПН-1