

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 16676 от 29 июня 2023 г.

Срок действия до 29 августа 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

Преобразователи давления ПД150И

Производитель:

ООО «Производственное объединение ОВЕН», г. Москва, Российская Федерация

Документ на поверку:

КУВФ.406233.300-001МП «Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи давления ПД150И. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **24 месяца**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.06.2023 № 48

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Мисіф. С

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 29 июня 2023 г. № 16676

Наименование типа средств измерений и их обозначение: преобразователи давления ПД150И

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: представлены в таблицах 1 – 5.

Таблица 1 – Обязательные метрологические характеристики преобразователей, измеряющих избыточное давление (с кодом типа измеряемого давления ДИ)

Наименование характеристики	Значение
Нижний предел измерений/преобразований давления, кПа	0
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	100
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	0,25
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления ²⁾ , %: для исполнений с ВПИ/ВПП 0,25 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП 0,3 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,4 до 0,8 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 1,0 до 2,0 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 2,5 до 8,0 кПа и от 80,0 до 100,0 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 10,0 до 60,0 кПа	 ±2,5 ±2,0 ±1,5 ±1,0 ±0,5 ±0,25
¹⁾ В таблице приведено значение максимального верхнего предела измерений/преобразований давления. Конкретное значение верхнего предела измерений/преобразований зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте.	
²⁾ Диапазон измерений/преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований.	

Таблица 2 – Обязательные метрологические характеристики преобразователей, измеряющих дифференциальное давление (с кодом типа измеряемого давления ДД).

Наименование характеристики	Значение
Нижний предел измерений/преобразований давления, кПа	0
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	100
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	0,25
Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	100
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления ²⁾ , %: для исполнений с ВПИ/ВПП 0,25 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,3 до 0,8 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 1,0 до 2,0 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 2,5 до 8,0 кПа и от 80,0 до 100,0 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 10,0 до 60,0 кПа	±2,5 ±1,5 ±1,0 ±0,5 ±0,25
¹⁾ В таблице приведено значение максимального верхнего предела измерений/преобразований давления. Конкретное значение верхнего предела измерений/преобразований зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте.	
²⁾ Диапазон измерений/преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований.	

Таблица 3 – Обязательные метрологические характеристики преобразователей, измеряющих вакуумметрическое давление (с кодом типа измеряемого давления ДВ).

Наименование характеристики	Значение
Нижний предел измерений/преобразований давления, кПа	0
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	-100
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	0,25
Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	100
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления ²⁾ , %: для исполнений с ВПИ/ВПП 0,25 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,3 до 0,8 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 1,0 до 2,0 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 2,5 до 5,0 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 6,0 до 30,0 кПа и от 50,0 до 100,0 кПа	±2,5 ±1,5 ±1,0 ±0,5 ±0,25
¹⁾ В таблице приведены значения максимальных верхних пределов измерений/преобразований давления. Конкретное значение верхнего предела измерений/преобразований зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте.	
²⁾ Диапазон измерений/преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований.	

Таблица 4 – Обязательные метрологические характеристики преобразователей, измеряющих избыточно-вакуумметрическое давление (с кодом типа измеряемого давления ДИВ).

Наименование характеристики	Значение
Максимальный нижний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	-100
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	100
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	0,40
Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	200
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерения/преобразования давления ²⁾ , %: для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,20 до 0,25 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,3 до 0,6 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,8 до 1,6 кПа для исполнений с ВПИ/ВПП от 2,0 до 100,0 кПа	±1,5 ±1,0 ±0,5 ±0,25
¹⁾ В таблице приведены значения максимальных нижнего и верхнего пределов измерений/преобразований давления. Конкретное значение нижнего и верхнего предела измерений/преобразований зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте.	
²⁾ Диапазон измерений/преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований.	

Таблица 5 – Обязательные метрологические характеристики преобразователей (с кодами типа измеряемого давления ДИ, ДД, ДВ, ДИВ).

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности срабатывания сигнализирующего устройства ¹⁾ , %	$\pm(0,2+ \gamma)$
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) дополнительной погрешности измерения/преобразования давления при изменении температуры окружающей среды от -20 °С до +18 °С не включ. и св. +28 °С до +70 °С, на каждые 10 °С, %	$\pm(0,5 \cdot \gamma)$
Вариация измеренного/преобразованного значения давления, %, не более	$0,5 \cdot \gamma $
Нормальные условия измерений: температура окружающей среды, °С относительная влажность воздуха без конденсации, %, не более атмосферное давление, кПа	от +18 до +28 80 от 84,0 до 106,7
¹⁾ γ – пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) основной погрешности измерений давления.	

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблице 6.

Таблица 6

Наименование характеристики	Значение
Цифровые интерфейсы	RS-485
Рабочие условия измерений: температура окружающей среды, °С	от -20 до +70
относительная влажность воздуха без конденсации при температуре окружающего воздуха +35 °С, %, не более	85
атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Напряжение питания постоянного тока, В	от 20 до 60 (номинальное 24)
Параметры питания переменного тока: напряжение, В	от 90 до 264 (номинальное 230)
частота, Гц	от 47 до 63 Гц (номинальная 50)
Потребляемая мощность, Вт, не более	8,0
Масса, кг, не более	0,4
Габаритные размеры (длина×высота×глубина), мм, не более: тип корпуса 809 (щитовое крепление)	96×96×87
тип корпуса 899 (настенное крепление)	105×137×60
Средняя наработка на отказ, ч	500000
Средний срок службы, лет	12

Комплектность: в соответствии с таблицей 9 Приложения.

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Поверка осуществляется по КУВФ.406233.300-001МП «Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи давления ПД150И. Методика поверки», согласованной в 2022 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей 2 Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Приведенные по тексту Приложения ссылки на документы «Р 50.2.077-2014», Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа», Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2021 г. № 1904 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений разности давления до $1 \cdot 10^5$ Па» для Республики Беларусь носят справочный характер.

Фотографии общего вида средств измерений носят иллюстративный характер и представлены на рисунках 2, 3 Приложения.

Место нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа: отсутствует.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 86595-22, на 8 листах.

Директор БелГИМ



А.В.Казачок

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи давления ПД150И

Назначение средства измерений

Преобразователи давления ПД150И (далее - преобразователи) предназначены для измерений избыточного давления, вакуумметрического давления, избыточно-вакуумметрического давления и дифференциального давления, отображения измеренного значения давления на встроенном индикаторе, преобразований измеренных значений давления в унифицированный аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока или цифровой выходной сигнал, а также сигнализации достижения измеряемого параметра уставок посредством управления дискретными релейными выходами.

Описание средства измерений

Принцип действия преобразователей основан на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией чувствительного элемента. В качестве чувствительного элемента используется мембрана, которая механически воздействует на диэлектрик, на котором размещена тензочувствительная полупроводниковая схема из четырех кремниевых тензорезисторов, соединенных в мост Уитсона. Под действием давления измеряемой среды мембрана с тензорезисторами прогибается. При этом тензорезисторы деформируются, изменяют свое сопротивление, что в свою очередь приводит к разбалансу моста, пропорциональному измеряемому давлению. Указанный разбаланс, выраженный в виде электрического сигнала, преобразуется электронным блоком, расположенным в корпусе преобразователя, в значение измеряемого давления, отображаемое на цифровом индикаторе, и в выходной сигнал силы постоянного тока от 4 до 20 мА в соответствии с ГОСТ 26.011-80 или цифровой сигнал RS-485.

Преобразователи конструктивно выполнены в пластмассовом корпусе, предназначенном для настенного или щитового крепления. Преобразователи имеют светодиодный индикатор.

Преобразователи выпускаются в различных исполнениях, отличающихся типом измеряемого давления, верхним пределом преобразований/измерений давления, пределами допускаемой основной погрешности, типом выходного сигнала, исполнением корпуса.

Структура условного обозначения исполнений преобразователей приведена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура условного обозначения исполнений преобразователей

Таблица 1 – Расшифровка структуры условного обозначения исполнений преобразователей

Позиция	Код	Описание
1	ПД150И	Обозначение наименования преобразователей
2	ДИ ДВ ДИВ ДД	Обозначение типа измеряемого давления: избыточное давление; вакуумметрическое давление; избыточно-вакуумметрическое давление; дифференциальное давление.
3	200П ²⁾ 250П 300П 400П 500П 600П 800П 1,0К 1,25К 1,6К 2,0К 2,5К 3,0К 4,0К 5,0К 6,0К 8,0К 10,0К 12,5К 16,0К 25,0К 30,0К 40,0К ³⁾ 50,0К 60,0К 80,0К 100К	Верхний предел измерений (далее – ВПИ)/преобразований (далее – ВПП) ¹⁾ : 0,2 кПа; 0,25 кПа; 0,3 кПа; 0,4 кПа; 0,5 кПа; 0,6 кПа; 0,8 кПа; 1,0 кПа; 1,25 кПа; 1,6 кПа; 2,0 кПа; 2,5 кПа; 3,0 кПа; 4,0 кПа; 5,0 кПа; 6,0 кПа; 8,0 кПа; 10,0 кПа; 12,5 кПа; 16,0 кПа; 25,0 кПа; 30,0 кПа; 40,0 кПа; 50,0 кПа; 60,0 кПа; 80,0 кПа; 100,0 кПа.
4	809 899	Тип корпуса: 809 – щитовое крепление; 899 – настенное крепление.
5	0,25 0,5 1,0	Пределы допускаемой приведенной (к основной погрешности) измерений/преобразований давления: ±0,25 %; ±0,5 %; ±1,0 %;
5	1,5 2,0 2,5	±1,5 %; ±2,0 %; ±2,5 %.
6	1	Тип встроенной индикации: светодиодная.

Позиция	Код	Описание
7	P	Тип дискретного выходного сигнала: электромагнитное реле.
8	отсутствует R	Тип выходного сигнала: от 4 до 20 мА; интерфейс передачи данных RS-485 с протоколом Modbus.

1) Для преобразователей, измеряющих вакуумметрическое давление (ДВ), приведено абсолютное значение ВПИ/ВПП.
2) Только для преобразователей, измеряющих избыточно-вакуумметрическое давление (ДИВ).
3) Кроме преобразователей, измеряющих вакуумметрическое давление (ДВ).

Заводской номер наносится на корпус преобразователя методом гравировки в виде цифрового кода.

Общий вид преобразователей с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера представлен на рисунках 2 – 3.

Нанесение знака поверки на преобразователи не предусмотрено. Пломбирование преобразователей не предусмотрено.



Рисунок 2 - Общий вид преобразователей давления ПД150И с типом корпуса 809 (щитовое крепление) с указанием мест нанесения знака утверждения типа и заводского номера



Рисунок 3 - Общий вид преобразователей давления ПД150И с типом корпуса 899 (настенное крепление)

Программное обеспечение

Преобразователи имеют встроенное программное обеспечение (далее – ПО), устанавливаемое в энергонезависимую память при изготовлении, выполняющее функции преобразования измеренного давления в унифицированный аналоговый выходной сигнал силы постоянного тока, а также в цифровой выходной сигнал по интерфейсу RS-485. Данное ПО не может быть модифицировано, загружено или прочитано через какой-либо интерфейс.

Конструкция преобразователей исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

ПО является метрологически значимым.

Метрологические характеристики преобразователей нормированы с учетом влияния ПО.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с рекомендациями Р 50.2.077-2014 - данное ПО защищено от преднамеренных изменений с помощью специальных программных средств.

Идентификационные данные ПО преобразователей приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
	преобразователи с выходным сигналом силы постоянного тока	преобразователи с цифровым выходным сигналом
Идентификационное наименование ПО	ПО_embSoft_ПД150-I_v1.27.hex	ПО_embSoft_ПД150-RS_v1.25.hex
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	1.27	1.25
Цифровой идентификатор ПО	-	-

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики преобразователей, измеряющих избыточное давление (с кодом типа измеряемого давления ДИ)

Наименование характеристики	Значение
Нижний предел измерений/преобразований давления, кПа	0
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	100
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	0,25
Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	100
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления ²⁾ , %:	
- для исполнений с ВПИ/ВПП 0,25 кПа	±2,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП 0,3 кПа	±2,0
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,4 до 0,8 кПа	±1,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 1,0 до 2,0 кПа	±1,0
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 2,5 до 8,0 кПа и от 80,0 до 100,0 кПа	±0,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 10,0 до 60,0 кПа	±0,25

¹⁾ В таблице приведено значение максимального верхнего предела измерений/преобразований давления. Конкретное значение верхнего предела измерений/преобразований зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте.

²⁾ Диапазон измерений/преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований.

Таблица 4 – Метрологические характеристики преобразователей, измеряющих дифференциальное давление (с кодом типа измеряемого давления ДД)

Наименование характеристики	Значение
Нижний предел измерений/преобразований давления, кПа	0
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	100
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	0,25
Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	100
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления ²⁾ , %:	
- для исполнений с ВПИ/ВПП 0,25 кПа	±2,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,3 до 0,8 кПа	±1,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 1,0 до 2,0 кПа	±1,0
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 2,5 до 8,0 кПа и от 80,0 до 100,0 кПа	±0,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 10,0 до 60,0 кПа	±0,25
¹⁾ В таблице приведено значение максимального верхнего предела измерений/преобразований давления. Конкретное значение верхнего предела измерений/преобразований зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте. ²⁾ Диапазон измерений/преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований.	

Таблица 5 – Метрологические характеристики преобразователей, измеряющих вакуумметрическое давление (с кодом типа измеряемого давления ДВ)

Наименование характеристики	Значение
Нижний предел измерений/преобразований давления, кПа	0
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	-100
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	0,25
Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	100
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления ²⁾ , %:	
- для исполнений с ВПИ/ВПП 0,25 кПа	±2,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,3 до 0,8 кПа	±1,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 1,0 до 2,0 кПа	±1,0
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 2,5 до 5,0 кПа	±0,5
- для исполнений с ВПИ/ВПП от 6,0 до 30,0 кПа и от 50,0 до 100,0 кПа	±0,25
¹⁾ В таблице приведены значения максимальных верхних пределов измерений/преобразований давления. Конкретное значение верхнего предела измерений/преобразований зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте. ²⁾ Диапазон измерений/преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований.	

Таблица 6 – Метрологические характеристики преобразователей, измеряющих избыточно-вакуумметрическое давление (с кодом типа измеряемого давления ДИВ)

Наименование характеристики	Значение
Максимальный нижний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	-100
Максимальный верхний предел измерений/преобразований давления, кПа ¹⁾	100
Минимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	0,40
Максимальный диапазон измерений/преобразований давления, кПа ²⁾	200

Наименование характеристики	Значение
Диапазон преобразований давления в выходной аналоговый сигнал силы постоянного тока, мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) основной погрешности измерений/преобразований давления ²⁾ , %: - для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,20 до 0,25 кПа - для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,3 до 0,6 кПа - для исполнений с ВПИ/ВПП от 0,8 до 1,6 кПа - для исполнений с ВПИ/ВПП от 2,0 до 100,0 кПа	±1,5 ±1,0 ±0,5 ±0,25
¹⁾ В таблице приведены значения максимальных нижнего и верхнего пределов измерений/преобразований давления. Конкретное значение нижнего и верхнего предела измерений/преобразований зависит от исполнения преобразователя и указывается в паспорте. ²⁾ Диапазон измерений/преобразований – модуль алгебраической разницы между значениями верхнего и нижнего пределов измерений/преобразований.	

Таблица 7 – Метрологические характеристики преобразователей (с кодами типа измеряемого давления ДИ, ДД, ДВ, ДИВ)

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности срабатывания сигнализирующего устройства ¹⁾ , %	$\pm(0,2+ \gamma)$
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений/преобразований) дополнительной погрешности измерений/преобразований давления при изменении температуры окружающей среды от -20 до +18 не включ. и св. +28 до +70 °С, на каждые 10 °С, %	$\pm(0,5 \cdot \gamma)$
Вариация измеренного/преобразованного значения давления, %, не более	$0,5 \cdot \gamma $
Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха без конденсации, %, не более - атмосферное давление, кПа	от +18 до +28 80 от 84,0 до 106,7
¹⁾ γ – пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) основной погрешности измерений давления.	

Таблица 8 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Цифровые интерфейсы	RS-485
Рабочие условия измерений: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха без конденсации при температуре окружающего воздуха +35 °С, %, не более - атмосферное давление, кПа	от -20 до +70 85 от 84,0 до 106,7
Напряжение питания постоянного тока, В	от 20 до 60 (номинальное 24)
Параметры питания переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц	от 90 до 264 (номинальное 230) от 47 до 63 Гц (номинальная 50)
Потребляемая мощность, Вт, не более	8,0
Масса, кг, не более	0,4

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры (длина×высота×глубина), мм, не более: - тип корпуса 809 (щитовое крепление) - тип корпуса 899 (настенное крепление)	96×96×87 105×137×60
Средняя наработка на отказ, ч	500000
Средний срок службы, лет	12

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом и на маркировочную наклейку, нанесенную на корпус преобразователей, любым технологическим способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 9 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Преобразователь давления ПД150И	-	1 шт.
Паспорт и Гарантийный талон	КУВФ.406233.300ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	КУВФ.406233.300РЭ	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 4 «Устройство и работа преобразователя» руководства по эксплуатации КУВФ.406233.300РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 июня 2018 г. № 1339 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2021 года № 1904 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений разности давлений до $1 \cdot 10^5$ Па»;

ТУ 26.51.52-010-4652536-2021 «Преобразователи давления ПД150И. Технические условия».

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение ОВЕН» (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»)

Адрес юридического лица: 111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
ИНН 7722127111

Изготовители

Общество с ограниченной ответственностью «Производственное Объединение ОВЕН» (ООО «Производственное Объединение ОВЕН»)


Адрес юридического лица: 111024, г. Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
Адрес места осуществления деятельности: 301830, Тульская область, г. Богородицк, Заводской проезд, стр. 2 «Б»
ИНН 7722127111

Испытательный центр

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «ЭНЕРГО» (ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)

Место нахождения и адрес юридического лица: 117405, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Дорожная, д. 60, эт./пом. 1/1, ком. 14-17

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.314019.

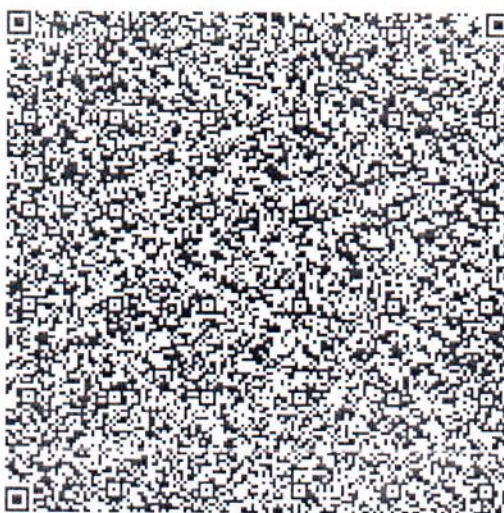

Копия верна 