

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 16694 от 29 июня 2023 г.

Срок действия до 9 октября 2027 г.

Наименование типа средств измерений:

Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ

Производитель:

ООО «Инфраспек», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Документ на поверку:

МП-242-1460-2012 «Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками: **12 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29.06.2023 № 48

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак

Мессинг -

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений

от 29 июня 2023 г. № 16694

Наименование типа средств измерений и их обозначение:
фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ

Назначение и область применения: в соответствии с разделом «Назначение средства измерений» Приложения.

Описание: в соответствии с разделом «Описание средства измерений» Приложения.

Обязательные метрологические требования: рабочая область спектра; спектральное разрешение; пределы допускаемой абсолютной погрешности шкалы волновых чисел; пределы допускаемого отклонения сигнала 100 % пропускания от номинального значения; среднеквадратическое отклонение сигнала 100 % пропускания; уровень псевдорассеянного света, значения приведены в таблице из разделе «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям: габаритные размеры; размеры кюветного отделения; масса; напряжение питания при частоте (50 ± 1) Гц; потребляемая мощность (без компьютера); время установления рабочего режима; средняя наработка на отказ; средний срок службы; условия эксплуатации, значения приведены в таблице из разделе «Метрологические и технические характеристики» Приложения.

Комплектность: в соответствии с таблицей из раздела «Комплектность средства измерений».

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: на средстве измерений и/или на эксплуатационных документах.

Сведения о методиках (методах) измерений: в соответствии с разделом «Сведения о методиках (методах) измерений» Приложения.

Поверка осуществляется по МП-242-1460-2012 «Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ. Методика поверки», утвержденной в 2012 г.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие:

требования к типу средств измерений: в соответствии с разделом «Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений» Приложения.

Перечень средств поверки: в соответствии с разделом «Поверка» Приложения.

Идентификация программного обеспечения: в соответствии с таблицей из раздела «Программное обеспечение» Приложения.

Программное обеспечение: в соответствии с разделом «Программное обеспечение» Приложения.

Производитель средств измерений: в соответствии с разделом «Изготовитель» Приложения.

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений: в соответствии с разделом «Испытательный центр» Приложения.

Фотография общего вида средств измерений носит иллюстративный характер и представлена на рисунке 1 Приложения.

Место нанесения знака поверки: на свидетельство о поверке.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа: отсутствует.

Приложение: описание типа средств измерений, регистрационный номер: № 52298-12, на 4 листах.

Директор БелГИМ



А.В.Казачок

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ

Назначение средства измерений

Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ предназначены для измерения оптических спектров в инфракрасной области в твердых, жидких и газообразных образцах, а также количественного анализа органических и неорганических веществ, по спектрам в инфракрасной области.

Описание средства измерений

Принцип действия прибора заключается в использовании двухлучевого интерферометра Майкельсона, в котором оптическая разность хода изменяется за счет движения (сканирования) одного из зеркал в плечах интерферометра. Оптическое излучение от источника проходит через интерферометр, на выходе которого регистрируется интерферограмма, представляющая собой зависимость интенсивности светового потока от оптической разности хода. Спектр, как зависимость интенсивности излучения от волнового числа, получается путем обратного преобразования Фурье интерферограммы, выполняемого с использованием персонального компьютера.

Сканирование зеркала в интерферометре осуществляется с помощью прецизионного механизма и системы управления, обеспечивающей стабилизацию скорости сканирования на участке регистрации интерферограммы. Оптическая разность хода определяется с помощью референтного канала, регистрирующего интерферограмму излучения He-Ne лазера на том же интерферометре.

Фурье-спектрометр имеет модульную конструкцию и выполнен в виде настольного прибора с отдельным компьютером. Модуль интерферометра герметизирован и может быть осушен или заполнен инертным газом.

В кюветном отделении фурье-спектрометра могут устанавливаться различные кюветы для исследования жидкостей и газов, а также приставки для измерения зеркального и диффузного отражения и спектров МНПВО. Имеется выходной оптический порт с коллимированным световым пучком. Модификации приборов отличаются рабочей областью спектра, спектральным разрешением и габаритными размерами. Перечень модификаций: ФСМ 1201, ФСМ 2201, ФСМ 1202, ФСМ 2202, ФСМ 2203, ФСМ 2211.

Внешний вид всех модификаций фурье-спектрометров в целом одинаков.

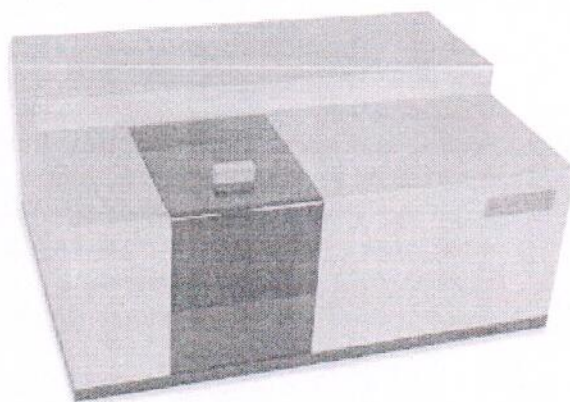


Рисунок 1. Внешний вид фурье-спектрометра модификации ФСМ 1201

Программное обеспечение

Фурье-спектрометры оснащены программным обеспечением (ПО) для персонального компьютера, которое управляет работой фурье-спектрометра, обрабатывает, отображает и сохраняет полученные данные.

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма метрологической значимой части ПО)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Программа для управления инфракрасным фурье-спектрометром	FSpec	4.0 или выше	5296FBF7 (файл Spectracalc.dll)	CRC32

К метрологически значимой части ПО относится программный модуль Spectracalc.dll). Метрологически значимая часть ПО обеспечивает преобразование первичных данных в спектр.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании последних.

Метрологические и технические характеристики

Рабочая область спектра, см ⁻¹ : ФСМ 1201, ФСМ 1202 ФСМ 2201, ФСМ 2202, ФСМ 2203 ФСМ 2211	от 400 до 7800 от 370 до 7800 от 3700 до 12500
Спектральное разрешение, см ⁻¹ , не более: ФСМ 1201, ФСМ 2201 ФСМ 1202, ФСМ 2202 ФСМ 2203 ФСМ 2211	1,0 0,5 0,125 2,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности шкалы волновых чисел, см ⁻¹ : ФСМ 1201, ФСМ 2201, ФСМ 1202, ФСМ 2202 ФСМ 2203 ФСМ 2211	±0,05 ±0,02 ±0,1
Пределы допускаемого отклонения сигнала 100% пропускания от номинального значения (разрешение 4 см ⁻¹ , 20 сканов), %: ФСМ 1201, ФСМ 2201, ФСМ 1202, ФСМ 2202, ФСМ 2203 (спектральный интервал от 2100 до 2200 см ⁻¹) ФСМ 2211 (спектральный интервал от 4500 до 4600 см ⁻¹)	±0,5 ±0,5

Среднеквадратическое отклонение сигнала 100% пропускания (разрешение 4 см ⁻¹ , 20 сканов), %, не более:	
ФСМ 1201, ФСМ 1202 (спектральный интервал от 2100 до 2200 см ⁻¹)	±0,02
ФСМ 2201, ФСМ 2202, ФСМ 2203 (спектральный интервал от 2100 до 2200 см ⁻¹)	±0,01
ФСМ 2211 (спектральный интервал от 4500 до 4600 см ⁻¹)	±0,02
Уровень псевдорассеянного света (при разрешении 4 см ⁻¹ и 20 сканах регистрации), %, не более:	
ФСМ 1201, ФСМ 2201, ФСМ 1202, ФСМ 2202, ФСМ 2203	±0,2
Габаритные размеры, мм, не более:	
ФСМ 1201, ФСМ 2201, ФСМ 1202, ФСМ 2202, ФСМ 2211	520×370×250
ФСМ 2203	540×490×250
Размеры кюветного отделения, мм, не менее:	
ФСМ 1201, ФСМ 1202	150×190×170
ФСМ 2201, ФСМ 2202, ФСМ 2211, ФСМ 2203	200×190×170
Масса, не более, кг:	
ФСМ 1201, ФСМ 2201, ФСМ 1202, ФСМ 2202, ФСМ 2211	28
ФСМ 2203	36
Напряжение питания при частоте (50±1) Гц, В	220 (-33/+22)
Потребляемая мощность (без компьютера), В·А, не более	60
Время установления рабочего режима, мин.	60
Средняя наработка на отказ, ч	2500
Средний срок службы, лет	6
Условия эксплуатации:	
диапазон изменения температуры, °С	от 10 до 35
диапазон изменения атмосферного давления, кПа	от 84 до 106,7
диапазон изменения относительной влажности, % при t=25°C	от 20 до 80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на лицевую панель корпуса фурье-спектрометра в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Поз.	Наименование и условное обозначение	Обозначение	Кол.
1	Фурье-спектрометр ФСМ		1
2	Программное обеспечение FSpec		1
3	Кабель для подключения к компьютеру		1
4	Кабель сетевого питания		1
5	Комплект ЗИП		1
6	Комплект документации		1
	Паспорт		1
	Руководство по эксплуатации		1
	Методика поверки		1

Поверка

осуществляется в соответствии с документом «МП 242-1460-2012. Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 25.11.2012 г.

Основные средства поверки: пленки полистирола толщиной от 25 до 30 и от 70 до 90 мкм по ГОСТ 20282-86.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе «Фурье-спектрометры инфракрасные ФСМ. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к фурье-спектрометрам инфракрасным ФСМ

Технические условия ТУ-4434-001-82256433-10.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

при выполнении работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

ООО «Инфраспек», Санкт-Петербург.

Юридический адрес: 196158, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 88, пом. 37Н, литер А.

Почтовый адрес: 196158, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 88, пом. 37Н, литер А.

Тел./факс: (812) 382-8857, (812) 382-9064

E-mail: info@infraspek.ru, Веб-сайт: <http://www.infraspek.ru>

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», рег. номер 30001-10.

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19.

Тел.: (812) 251-7601, факс: (812) 713-0114, E-mail: info@vniim.ru

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



Ф.В.Булыгин

» 17. 01 2013 г.

