

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие виброустойчивые М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ

Назначение средства измерений

Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие виброустойчивые М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ (далее – приборы) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления некристаллизующихся жидкостей, паров, газов, в том числе кислорода, аммиака, ацетилена, сероводородосодержащих сред, хладонов 12, 13, 22, 134а, 142, 404а, 502, газодонефтяной эмульсии, нефти и нефтепродуктов.

Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на уравнивании измеряемого давления силами упругой деформации манометрической пружины, один конец которой неподвижно соединен с держателем, а другой конец подвижный, связан с трибно-секторным механизмом. Перемещение конца трубчатой пружины преобразуется в поворот указательной стрелки.

Приборы М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ изготавливаются в корпусе диаметром 100 мм, М-4ВУ, МВ-4ВУ, В-4ВУ — в корпусе диаметром 160 мм.

Виброустойчивость приборов М-3ВУ, МВ-3ВУ, В-3ВУ достигается за счёт жидкостного демпфирования осей трибки и сектора. Нижняя плата механизма армирована полиамидом в виде двух цилиндрических колпачков. На цапфы осей трибки и сектора посажены барабаны. В цилиндрический зазор между барабаном и колпачком введена демпфирующая жидкость. При повороте трибки и оси сектора жидкостное трение в зазоре создаёт демпфирующую силу.

Виброустойчивость приборов М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, В-3ВУКс и М-3ВУКс, МВ-3ВУКс, В-3ВУКс обеспечивается за счет заполнения полости корпуса полиметилсилоксановой жидкостью.


Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 70 °С для климатического исполнения У2 и ОМ2, и от минус 45 до плюс 70 °С (по заказу потребителя от минус 65 до плюс 70 °С) для климатического исполнения УХЛ1.

По защищенности от проникновения внутрь внешних твердых предметов и воды приборы исполнений У2 и ОМ2 соответствуют степени защиты IP54 по ГОСТ 14254-96, приборы исполнения УХЛ1 - IP65 по ГОСТ 14254-96.

Обозначения климатических исполнений по ГОСТ 15150-69 - У2, ОМ2, УХЛ1

Модификация приборов: Кс – коррозионностойкие.

Фотографии общего вида приборов приведены на рисунке 1.

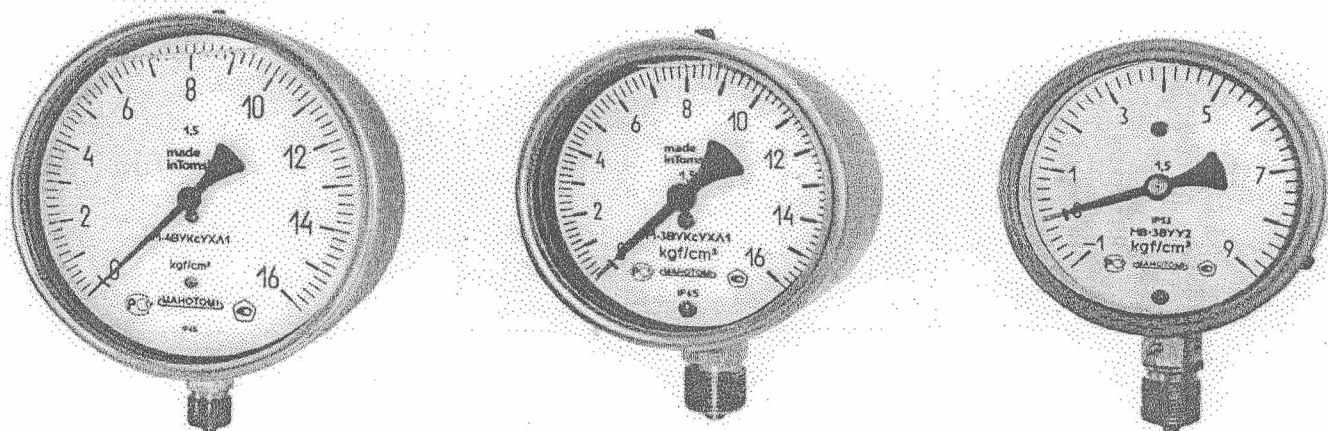

Метрологические и технические характеристики

Пределы допускаемой основной погрешности показаний приборов соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

Класс точности	Пределы допускаемой основной погрешности, % диапазона показаний
1	± 1
1,5	$\pm 1,5$

Диапазон измерений и измеряемая среда соответствуют таблице 2.

Таблица 2

Условное обозначение прибора и климатическое исполнение	Верхнее значение диапазона показаний				Класс точности	Измеряемая среда		
	избыточного давления		вакуумметрического давления					
	кПа (кгс/см ²)	МПа (кгс/см ²)	кПа (кгс/см ²)	МПа (кгс/см ²)				
М-ВУ	100 (1) 160 (1,6)	-	-	-	1,5	Жидкость, пар, газ		
	250 (2,5) 400 (4) 600 (6)							
	-	1 (10) 1,6 (16) 2,5 (25) 4 (40) 6 (60) 10 (100) 16 (160) 25 (250) 40 (400)			-		-	1; 1,5
		60 (600) 100 (1000) 160 (1600)						
В-ВУ	-	-60 (0,6) -100 (-1)	-	-	1,5			
МВ-ВУ	60 (0,6)	-	-100 (-1)	-	1; 1,5	Жидкость, пар, газ		
	150 (1,5) 300 (3) 500 (5)							
	-	0,9 (9) 1,5 (15) 2,4 (24)	-	-0,1 (-1)				

Продолжение таблицы №2

Условное обозначение прибора	Верхнее значение диапазона показаний				Класс точности	Измеряемая среда
	избыточного давления		вакуумметрического давления			
	кПа (кгс/см ²)	МПа (кгс/см ²)	кПа (кгс/см ²)	МПа (кгс/см ²)		
МВ-ВУ	300 (3) 500 (5)	—	-100 (-1)	—	1; 1,5	Хладон 22; 134а; 404а
	—	0,9 (9)	—	-0,1 (-1)		Хладон 22; 134а; 142; 404а
		1,5 (15) 2,4 (24)				Хладон 12; 13; 22; 134а; 142; 404а; 502

Примечание: Для приборов модификации Кс измеряемой средой являются: жидкий, газообразный и водный раствор аммиака, сероводородосодержащие среды

Диапазон измерений избыточного давления равен:

- 75 % верхнего значения диапазона показаний - при постоянном давлении;
- 66 % верхнего значения диапазона показаний - при переменном давлении.

Диапазон измерений вакуумметрического давления равен диапазону показаний.

Вариация показаний приборов не превышает абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

Изменение показаний от воздействия температуры окружающего воздуха, выраженное в процентах диапазона показаний, не должно превышать значения, определяемого по формуле

$$\Delta = \pm K_t \cdot \Delta t,$$

где K_t – температурный коэффициент, не более 0,06 %/°C - для приборов класса точности 1; 1,5;

Δt – абсолютное значение разности температур, определяемое по формуле

$$\Delta t = |t_2 - t_1|,$$

где t_2 – действительное значение температуры окружающего воздуха;

t_1 – любое действительное значение температуры окружающего воздуха, равное 23 °C с допускаемым отклонением:

± 2 °C - для приборов класса точности 1;

± 5 °C - для приборов классов точности 1,5.

Масса приборов:

- в корпусе диаметром 100 мм не более

0,8 кг

- в корпусе диаметром 160 мм не более

1,6 кг

Полный средний срок службы приборов не менее

8 лет.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на циферблат офсетной печатью, на эксплуатационную документацию - типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входит:

Прибор

- 1 шт. (в соответствии с договором)

Паспорт 5Ш0.283.290 ПС

- 1 экз. (для нужд народного хозяйства)

Паспорт 5Ш0.283.344 ПС

- 1 экз. (для экспорта)

Паспорт 5Ш0.283.456 ПС

- 1 экз. (для АЭС (внутренний рынок))

Паспорт 5Ш0.283.457 ПС	- 1 экз. (для АЭС (экспорт))
Паспорт 5Ш0.283.470 ПС	- 1 экз. (для внутреннего рынка (УХЛ1))
Паспорт 5Ш0.283.471 ПС	- 1 экз. (для экспорта (УХЛ1))
Паспорт 5Ш0.283.472 ПС	- 1 экз. (для АЭС (внутренний рынок) УХЛ1)
Паспорт 5Ш0.283.473 ПС	- 1 экз. (для АЭС (экспорт) УХЛ1)
Руководство по эксплуатации 5Ш0.283.290 РЭ	- 1 экз. (для нужд народного хозяйства) - 1 экз. (для экспорта)

Поверка

Поверка приборов проводится в соответствии с МИ 2124-90 "Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки".

Основные средства поверки:

- манометры грузопоршневые МВП-2,5; МП-6; МП-60; МП-600; МП-2500
кл. точн. 0,05.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе 5Ш0.283.290 РЭ «Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие виброустойчивые М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ»

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам

ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

ГОСТ Р 8.802-2012 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа».

Технические условия ТУ 25-7310.041-2014 «Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие виброустойчивые М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Манотомь» (ОАО «Манотомь»)

Юридический адрес: 634061, Россия, г. Томск, пр. Комсомольский, 62

Почтовый адрес: 634061, Россия, г. Томск, пр. Комсомольский, 62

Тел. (3822) 44-26-28; факс (3822) 44-29-06, 44-28-43;

e-mail: priem@manotom-tmz.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;


E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



Ф.В. Булыгин

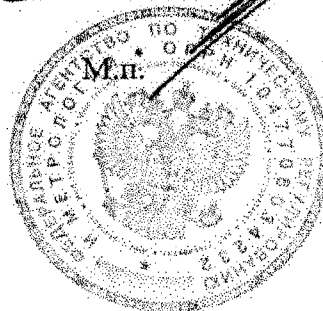

25 09 2014 г.

